
**ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ЕАСС)**

**EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(EASC)**



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ**

ГОСТ 11607-1
*(проект, RU,
первая
редакция)*

**УПАКОВКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ФИНИШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

Часть 1

**Требования к материалам, барьерным системам для
стерилизации и упаковочным системам**

(ISO 11607-1:2006, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Дюпон Наука и Технологии» (ООО «Дюпон Наука и Технологии») на основе перевода ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на русский язык англоязычной версии стандарта и на основе собственного перевода на русский язык Приложения №1, указанных в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол от г. N)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004-97	Код страны по МК (ISO 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Украина	UA	Минэкономики Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от N межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11607-1

введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 11607-1:2006 Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 1. Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам), включая все изменения Adm.1:2014.

. Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 198 «Стерилизация медицинских изделий» Международной организации по стандартизации (ISO).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий международный стандарт, и международные стандарты,

ГОСТ ISO 11607-1

(проект, RU, первая редакция)

на которые даны ссылки, имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВЗАМЕН

ГОСТ ISO 11607

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Общие требования	
4.1 Общие условия	
4.2 Системы качества	
4.3 Отбор проб.....	
4.4 Методы испытания.....	
4.5 Документация.....	
5 Материалы и предварительно отформованные барьерные системы для стерилизации	
5.1 Общие требования	
5.2 Свойства микробного барьера	
5.3 Совместимость с процессом стерилизации	
5.4 Совместимость с системой маркировки	
5.5 Хранение и транспортировка	
6 Конструктивные требования и требования к разработке упаковочных систем	
6.1 Общие требования	
6.2 Конструкция.....	
6.3 Эксплуатационные испытания упаковочной системы.....	
6.4 Испытание на стабильность характеристик	
7 Предоставляемая информация.....	
Приложение А (информативное) Руководство по упаковке медицинских изделий.....	
Приложение В (информативное) Стандартные методы испытаний и процедуры, которые могут применяться для	

демонстрации соответствия требованиям настоящего стандарта.....

Приложение С (нормативное) Метод испытания для определения сопротивления непроницаемых материалов прохождению воздуха

Приложение ДА (информативное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам.....

Библиография.....

Введение

Процесс конструирования и разработки упаковочных систем для финишной стерилизации медицинских изделий является сложным и ответственным этапом. Компоненты изделия и упаковочную систему следует сочетать так, чтобы получить продукт, который бы рационально, безопасно и эффективно соответствовал своему назначению в руках пользователя.

В настоящем стандарте установлены основные характеристики материалов и предварительно отформованных систем для применения их в упаковочных системах, предназначенных для финишной стерилизации медицинских изделий, а также рассматривается широкий диапазон потенциальных материалов, медицинских изделий, конструкций систем упаковки и методов стерилизации.

В ISO 11607-2 описаны требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки. Настоящий стандарт заменяет EN 868-1 и устанавливает общие требования ко всем упаковочным материалам, тогда как в EN 868, части 2 – 10 устанавливаются частные требования к целому ряду общеупотребительных материалов. Обе части ISO 11607 разработаны в соответствии с основополагающими требованиями Европейских Директив, касающихся медицинских изделий.

Действуют европейские стандарты, содержащие требования к конкретным материалам и предварительно отформованным барьерным системам для стерилизации, которые известны как стандарты серии EN 868. Настоящий стандарт разработан в качестве средства для демонстрации соблюдения основополагающих требований Европейских Директив, касающихся медицинских изделий.

Соответствие с EN 868, части 2 – 10 может быть использовано для подтверждения соблюдения одного или более требований настоящего стандарта.

Системы упаковки медицинских изделий, подлежащих окончательной стерилизации, предназначены для стерилизации изделий, обеспечения их физической защиты, сохранения стерильности до места использования и соблюдения асептических свойств.

Особенности медицинского изделия, предполагаемые методы стерилизации, срок годности, транспортирование и хранение влияют на конструкцию упаковочной системы и выбор материала.

Одним из существенных препятствий для гармонизации является терминология. Термины “упаковка”, “конечная упаковка”, “конечная тара”, “первичная тара”, и “первичная упаковка” имеют различный смысл в разных странах, и выбор одного из этих терминов как основы для гармонизации с настоящим стандартом явился барьером для успешного завершения разработки этого документа.

В результате, был введен термин “барьерная система для стерилизации” для описания минимальной упаковки, необходимой для выполнения особых требований, предъявляемых к медицинской упаковке, а именно: обеспечение условий для проведения стерилизации, создание приемлемого микробного барьера и соблюдение асептических свойств. “Защитная упаковка” предохраняет барьерную систему для стерилизации и вместе они образуют упаковочную систему. “Предварительно отформованные барьерные системы” могут включать любые части этой системы, например, саше, пакеты, запечатываемые с помощью этикетки, перегибаемой пополам, катушки для намотки упаковочной пленки, применяемые в больницах.

Обзор барьерных систем для стерилизации можно найти в приложении А.

Барьерная система важна для обеспечения безопасности медицинских изделий в процессе финишной стерилизации. Регламентирующие органы признают важную роль барьерных систем для стерилизации, рассматривая их как вспомогательное средство или компонент медицинского изделия.

Предварительно отформованные барьерные системы, которые продают медицинским учреждениям для использования в процессе внутренней стерилизации, признаются медицинскими изделиями во многих частях света.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УПАКОВКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНИШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Часть 1

Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам

Packaging for terminally sterilized medical devices . Part 1. Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к материалам, предварительно отформованным барьерным системам для стерилизации, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам, предназначенным для финишной стерилизации медицинских изделий до того, как они будут доставлены к месту их использования, а также описывает методы испытаний.

Настоящий стандарт применяется для упаковывания медицинских изделий, подвергаемых финишной стерилизации как в промышленности, так и в медицинских учреждениях, а также там, где медицинские изделия помещают в барьерные системы и стерилизуют.

Проект, первая редакция

Настоящий стандарт не применим к упаковочным материалам и/или системам, внутри которых находятся контаминированные медицинские изделия в процессе их транспортировки до места повторной обработки или утилизации.

Настоящий стандарт не распространяется на барьерные системы и упаковочные системы для медицинских изделий, которые изготовлены асептическим способом. Также может возникнуть необходимость в дополнительных требованиях к упаковке комплекса лекарство/изделие.

Настоящий стандарт не содержит требований к системе обеспечения качества для проведения контроля на всех стадиях производства.

(Внесен дополнительно, Изм. №1, 2014)

2 Нормативные ссылки

Перечисленные ниже нормативные документы (стандарты) являются обязательными при применении настоящего стандарта. Для датированных ссылок используют только указанную в ссылке редакцию. Для недатированных ссылок используют последнюю редакцию документа, на который дана ссылка, включая любые дополнения, изменения и поправки.

ISO 5636-5 Paper and board — Determination of air permeance and air resistance (medium range) — Part 5: Gurley method (Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости и сопротивления воздуха (средний диапазон измерения). Часть 5. Метод Герли)

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 асептическое представление (aseptic presentation): Внедрение и передача стерильного изделия с соблюдением условий и процедур, исключающих микробное заражение.

3.2

<p>бионагрузка (bioburden): Популяция жизнеспособных микроорганизмов на изделии или барьерной системе для стерилизации или внутри них.</p>

[ISO/TS 11139:2006]

3.3 укупорочное средство (closure): Средство, используемое для укупоривания стерильной барьерной системы без применения клеевого соединения.

Примечание — Например, стерильную барьерную систему можно укупорить уплотнительными крышками многоразового применения или последовательным сгибанием упаковки до образования скрученного канала.

3.4 целостность укупорочного средства (closure integrity): Свойства герметизирующего средства, позволяющие ему препятствовать проникновению микроорганизмов в заданных условиях, которые охватывают процесс стерилизации, обработку, распределение, транспортировку и хранение.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

3.5 срок годности (expiry date): Указание даты, обозначаемой как год и месяц, до которой продукт следует использовать.

3.6 маркировка (labelling): Этикетка с письменным, печатным, электронным или графическим отображением данных, прикрепляемая

к медицинскому изделию или упаковочной системе или прилагаемая в качестве сопроводительного документа.

Примечание — Маркировка содержит идентификацию, техническое описание и способ применения медицинского изделия, но исключает товаросопроводительные документы.

3.7

медицинское изделие (medical device): Любой инструмент, аппарат, прибор, машина, приспособление, имплант, реагент *in vitro* или калибратор, программные средства, материал или иное подобное изделие, предназначенное производителем для использования, отдельно или в сочетании, на людях для одной или нескольких определенных целей, как то:

- диагностика, предотвращение, мониторинг, лечение, облегчение заболевания,
- диагностика, мониторинг, лечение, облегчение или компенсация травмы,
- исследования, пересадка, модификация или поддержка органов или физиологического процесса,
- поддержание или обеспечение жизни,
- контроль зачатия,
- дезинфекция медицинских изделий,
- получение информации для медицинских целей посредством рассмотрения *in vitro* образцов, полученных из человеческого организма,

и которое не выполняет своего основного действия внутри или на человеческом теле с помощью фармакологических, иммунологических или метаболических средств, но функции которого могут быть поддержаны таковыми средствами.

[ISO 13485:2003]

Примечание — Это определение из ISO 13485:2003 было разработано специальной комиссией по глобальной гармонизации (GHTF 2002).

3.8 микробный барьер (microbial barrier): Свойства герметизирующего средства, позволяющие ему препятствовать проникновению микроорганизмов в заданных условиях, которые охватывают процесс стерилизации, обработку, распределение, транспортировку и хранение.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

3.9 упаковочный материал (packaging material): Любой материал, применяемый при изготовлении или укупоривании упаковочной системы.

3.10

упаковочная система (packaging system): Сочетание барьерной системы и защитной упаковки.

[ISO/TS 11139:2006]

3.11

предварительно отформованная барьерная система для стерилизации (preformed sterile barrier system): Барьерная система для стерилизации (3.22), которая поставляется частично собранной для наполнения и окончательного закрытия или укупоривания.

Пример — Саше, бумажные пакеты и открытые многоразовые упаковки.

[ISO/TS 11139:2006]

3.12

продукт (product): Результат процесса.

[ISO 9000:2005]

Примечание — Для обеспечения стандартов стерилизации продукт является вещественным материалом, к нему относится сырье, промежуточный продукт, сборочная единица и медико-санитарные товары.

[ISO/TS 11139:2006]

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

3.13 защитная упаковка (protective packaging): Конфигурация материалов, способствующая предотвращению повреждения стерильной барьерной системы и их содержимого с момента сборки и до места использования.

Примечание — Из ISO/TS 11139:2006.

3.14 повторно используемый материал (cycled material): Материал, полученный в процессе переработки отходов с целью придания им первоначальных свойств или для других целей.

3.15 повторяемость (repeatability): Точность соответствия между результатами последовательных измерений одного и того же определенного количества, подлежащего измерению (измеряемая величина), которое проводится в одних и тех же условиях.

Примечание 1 — Эти условия называют условиями повторяемости.

Примечание 2 — Условия повторяемости могут включать следующее:

- одну и ту же методику измерения;
- одного и того же эксперта;
- один и тот же измерительный инструмент, который используют в одних и тех же условиях;
- одно и то же место проведения измерения;
- повторение через короткий промежуток времени.

Примечание 3 — Повторяемость может быть выражена количественно на основании дисперсионных характеристик результатов.

Примечание 4 — Взято из Международного словаря основных и общих терминов в области метрологии, 1993, определение 3.6.

3.16 воспроизводимость (reproducibility): Точность соответствия между результатами измерений одного и того же определенного количества, подлежащего измерению (измеряемая величина), которое проводится в изменяющихся условиях.

Примечание 1 — Для обоснованного заявления воспроизводимости необходимы требования на изменение условий.

Примечание 2 — К изменяющимся условиям можно отнести:

- принцип измерения;
- метод измерения;
- эксперта;
- измерительный инструмент;
- стандартный образец;
- место проведения измерения;
- условия применения;
- время.

Примечание 3 — Воспроизводимость может быть выражена количественно на основании дисперсионных характеристик результатов.

Примечание 4 — Взято из *Международного словаря основных и общих терминов в области метрологии*, 1993, определение 3.7.

3.17 многоразовая упаковка (reusable container): Жесткая барьерная система для стерилизации, которая может использоваться многократно.

3.18 клеевое соединение (seal): Результат соединения поверхностей.

Примечание — Например, поверхности могут быть соединены с помощью клеев или термического плавления.

3.19 целостность клеевого соединения (seal integrity): Свойства клеевого соединения, позволяющие ему препятствовать проникновению микроорганизмов в заданных условиях, которые

охватывают процесс стерилизации, обработку, распределение, транспортировку и хранение.

3.20 прочность клеевого соединения (seal strength):

Механическая прочность клеевого соединения.

3.21

стерильность (sterile): Отсутствие жизнеспособных микроорганизмов.
[ISO/TS 11139:2006]

3.22

барьерная система для стерилизации (sterile barrier system): Минимальная упаковка, которая препятствует проникновению микроорганизмов и позволяет продемонстрировать асептические свойства продукта в месте его применения.
[ISO/TS 11139:2006]

3.23 стерильная упаковка для проводника жидкости (sterile fluid-path packaging): Система защитной оболочки для проводника жидкости и/или упаковки, предназначенная для обеспечения стерильности части медицинского изделия, контактирующей с жидкостями.

Примечание — Примером стерильной упаковки для проводника жидкости может служить внутренняя часть трубок для введения внутривенной жидкости.

3.24 совместимость со стерилизацией (sterilization compatibility): Свойства упаковочного материала и/или системы, позволяющие им выдерживать процесс стерилизации и обеспечивать достижение требуемых условий для стерилизации внутри упаковочной системы.

3.25

стерилизующий агент (sterilizing agent): Физическое или химическое вещество или комбинация веществ с достаточной микробицидной активностью для достижения стерильности в заданных условиях

[ISO/TS 11139:2006]

3.26 финишная стерилизация (terminal sterilization): Процесс, в результате которого стерилизуют продукт внутри барьерной системы для стерилизации.

3.27 срок полезного использования (useful life): Период времени, в течение которого удовлетворяются все требования к рабочим характеристикам.

3.28 валидация (validation): ⟨Общее⟩ Подтверждение путем исследований и обеспечение объективного свидетельства того, что конкретное требование к особому предполагаемому условию может быть выполнено.

Примечание — Это определение применимо к валидации методов испытания и конструкции.

3.29 валидация (validation): ⟨Процесс⟩ Документированная процедура получения, записи и интерпретации результатов, необходимых для подтверждения того, что процесс неизменно дает продукцию, соответствующую заданным требованиям.

Примечание — Взято из ISO/TS 11139:2006.

4 Общие требования

4.1 Общие условия

Соответствие одному или более требованиям настоящего стандарта может быть продемонстрировано путем использования

одной или более следующих частей стандарта серии EN 868-2 - EN 868-10.

4.2 Системы качества

4.2.1 Действия, описанные в настоящем стандарте, следует выполнять в рамках официальной системы качества.

Примечание— ISO 9001 и ISO 13485 содержат требования к соответствующим системам качества. Дополнительные требования могут быть установлены самой страной или регионом.

4.2.2 Не должно быть необходимости сертификации системы качества третьей стороной для выполнения требований настоящего стандарта.

4.2.3 Учреждения здравоохранения должны рассматривать использование системы качества, которая требуется в их стране или регионе.

4.2.2, 4.2.3 (Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

4.3 Отбор проб

Планы отбора проб, используемых для выбора и испытания упаковочных систем, должны быть применимы к системам упаковки, подлежащим оценке. Планы отбора проб должны базироваться на статистически обоснованных причинах.

Примечание — Примеры подходящих планов отбора проб приведены в ISO 2859-1 или ISO 186. Дополнительные планы отбора могут быть установлены самими странами или регионами.

4.4 Методы испытания

4.4.1 Все методы испытаний, применяемые для подтверждения соответствия настоящему стандарту, должны пройти валидацию и быть оформлены документально.

Примечание — Приложение В содержит перечень соответствующих методов испытаний.

4.4.2 Валидация метода испытания должна продемонстрировать пригодность применяемого метода. Она включает следующие элементы:

- разработку обоснования для выбора соответствующих методов испытаний упаковочных систем;

- разработку критериев приемки;

Примечание — Прошло успешно/окончилось неудачей – вид критерия приемки.

- определение повторяемости метода испытания;

- определение воспроизводимости метода испытания; и

- установление чувствительности метода для испытания целостности.

4.4.3 Если в методах испытания не установлено иное, образцы для испытания должны пройти кондиционирование при температуре $23\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ и относительной влажности $50\% \pm 2\%$ в течение 24 ч минимум.

4.5 Документация

4.5.1 Подтверждение соответствия настоящего стандарта должно быть документально оформлено.

4.5.2 Все документы должны храниться установленный период времени. При определении срока хранения документов следует учитывать такие факторы, как требования регламентов, срок годности и прослеживаемость причин отказов медицинских изделий или барьерной системы для стерилизации.

4.5.3 В документы соответствия могут быть включены, но не ограничены этим, эксплуатационные данные, технические условия и результаты валидированных методов испытаний.

4.5.4 Электронные записи, электронные и собственноручные подписи, исполненные в электронных записях, которые способствуют валидации, производственный контроль или другие процессы принятия решений по качеству, должны быть надежными.

5 Материалы и предварительно отформованные барьерные системы для стерилизации

5.1 Общие требования

5.1.1 Требования к материалам должны соответствовать тем, которые предъявляются к материалам, используемым в предварительно отформованных барьерных системах, а также в барьерных системах для стерилизации.

5.1.2 Требования, приведенные в подпункте (5.1) не являются полными. Материалы, имеющие характеристики, которые не указаны в этом подпункте, могут оцениваться с помощью критериев эффективности, приведенных в разделе 6.

5.1.3 Условия, в соответствии с которыми производят и обрабатывают материал или отформованную барьерную систему, должны устанавливаться, контролироваться и регистрироваться, если возможно, чтобы гарантировать:

a) совместимость этих условий с предполагаемым использованием материала и/или барьерной системы для стерилизации;

b) сохранение эксплуатационных характеристик материала и/или барьерной системы для стерилизации.

5.1.4 Как минимум необходимо учитывать следующее:

- a) температурный диапазон;
- b) диапазон давления;
- c) диапазон влажности;
- d) максимальную скорость изменения вышеперечисленного, где это возможно;
- e) воздействие солнечного света или ультрафиолета;
- f) чистоту;
- g) бионагрузку;
- h) электростатическую проводимость.

5.1.5 Источник, история и прослеживаемость всех материалов, особенно переработанных, должны быть известны и проконтролированы, чтобы гарантировать, что конечный продукт будет соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Примечание — При действующих технологиях маловероятно, что в переработанных материалах может использоваться что-то другое, кроме первичных производственных отходов, так как недостаточный контроль не позволяет безопасно применять другой переработанный материал а барьерных системах.

5.1.6 Необходимо оценить следующие свойства материала:

- a) микробный барьер (см. 5.2);
- b) биосовместимость и токсикологические признаки;

Примечание — Это обычно относится к материалам, находящимся в контакте с изделием. Руководство по биосовместимости дано в ISO 10993-1.

Необходимо оценить влияние стерилизации на биосовместимость.

- c) физические и химические свойства;
- d) совместимость с процессами формирования и склеивания;
- e) совместимость с установленными процессами стерилизации (см. 5.3);

f) любые ограничения сроков годности при хранении до и после стерилизации.

5.1.7 Материалы, например, оберточные, бумага, полимерная пленка, нетканый материал или многократно используемый волокнистый материал, должны соответствовать следующим общим требованиям:

a) материалы должны быть невыщелачивающимися и не иметь запаха в установленных условиях применения и в такой степени, чтобы это не повлияло ни на их характеристики, ни на их безопасность. Они также не должны негативно воздействовать на медицинские изделия, с которыми они контактируют;

Примечание — Для определения запаха не требуется применение стандартизованного метода испытания, так как неприятные запахи можно почувствовать.

b) в материалах не должно быть дыр, трещин, разрывов, морщин, складок или локализованных утолщений и/или утончений, способных ухудшить их функционирование;

c) плотность материалов (масса на единицу площади) должна соответствовать заданному значению;

d) материалы должны обнаруживать приемлемые уровни чистоты, наличие твердых частиц и пуха;

e) материалы должны соответствовать требованиям к заданным удельным или минимальным физическим свойствам, таким как прочность на растяжение, отклонение по толщине, сопротивление разрыву, воздухопроницаемость и прочность на продавливание;

f) материалы должны соответствовать заданным химическим свойствам (таким как величина pH, содержание хлоридов и сульфатов), чтобы удовлетворять требованиям к медицинским изделиям, упаковочным системам или процессам стерилизации;

g) материалы не должны содержать или выделять в достаточном количестве вещества, которые считаются токсичными, и могут нанести вред здоровью до, в процессе или после стерилизации в условиях их применения.

5.1.8 В дополнение к требованиям, указанным в 5.1.1 - 5.1.7, материалы с адгезионным слоем должны соответствовать нижеперечисленным требованиям:

a) структура адгезионного слоя должна быть непрерывной, без пропусков и разрывов, которые могут быть причиной дефектов склеивания;

b) плотность нанесения клея должна соответствовать установленному значению;

c) материалы должны продемонстрировать минимальную установленную прочность клеевого слоя при склеивании с другим материалом в заданных условиях.

5.1.9 В дополнение к требованиям, указанным в 5.1.1 - 5.1.7 и, в случае применимости, 5.1.8, барьерные системы для стерилизации и отформованные барьерные системы должны соответствовать нижеприведенным требованиям:

a) материалы и компоненты, например, покрытия, красящие или химические индикаторы, не должны негативно влиять на медицинское изделие в результате реакции, загрязнения и/или переноса до, во время или после процесса стерилизации.

b) при формировании склеиванием, должны соблюдаться требования к ширине и прочности клеевого слоя (прочность на разрыв и/или продавливание);

c) отслаивание упаковочного слоя при открывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или

разрыва материала, способного ухудшить асептические свойства упаковки и их представление при открывании;

Примечание 1 — Помимо требований к конструкции и форме бумажных пакетов и термосвариваемых саше и рулонов должны соблюдаться требования к их характеристикам.

Примечание 2 — Соблюдение максимальной прочности клеевого слоя может быть необходимо, если клеевые соединения будут открывать для презентации асептических свойств.

d) клеевые соединения и/или укупорочные средства должны обеспечивать барьер от проникновения микроорганизмов.

5.1.10 В дополнение к требованиям, указанным в 5.1.1 - 5.1.7, многоразовые упаковки должны соответствовать нижеприведенным требованиям:

a) каждая упаковка должны быть снабжена системой защиты от вскрытия, которая четко указывает на нарушение целостности укупорочного средства;

b) место прохождения стерилизующего агента должно обеспечивать барьер от проникновения микроорганизмов при выгрузке упаковки из стерилизатора, транспортировании и хранении (см. 5.2);

c) после формирования барьерной системы для стерилизации укупорочное средство должно обеспечивать барьер от проникновения микроорганизмов;

d) конструкция упаковки должна облегчить осмотр всех значимых частей;

e) перед каждым последующим применением необходимо установить критерии приемки для проведения визуального осмотра;

Примечание 1 — Помимо визуального контроля, являющегося наиболее общей процедурой, могут использоваться и другие методы приемки.

f) отдельные компоненты упаковки одной модели должны быть или полностью взаимозаменяемы или иметь конструкцию, в которой замена компонентов не предусмотрена;

Примечание 2 — Это требование к конструкции должно быть обозначено кодом или на ярлыке.

g) изготовитель должен указать методики обслуживания, чистки и способ контроля, текущего ремонта и замены компонентов.

Примечание 3 — Дополнительные руководства по применению многоразовой упаковки см. в EN 868-8.

5.1.11 В дополнение к требованиям, указанным в 5.1.1 - 5.1.7 и, если применимо, в 5.1.8, многоразовые волокнистые материалы должны соответствовать нижеприведенным требованиям:

a) после восстановления материала и после каждого цикла стерилизации должны быть соблюдены требования к эксплуатационным характеристикам;

b) должны быть установлены и документально оформлены способы обработки с целью промывки и очистки.

Примечание — Это может быть визуальный контроль, другие методы испытания и критерии приемки упаковки для повторного применения.

c) способы обработки должны соответствовать тем, которые указаны на этикетке.

5.1.12 Для многоразовых барьерных систем, включая упаковки и волокнистые материалы, следует определить, ведет ли обработка в соответствии с указанными инструкциями к порче системы, что может ограничить срок ее полезного использования. В тех случаях, когда порча предсказуема, количество циклов повторной обработки, которые может выдержать система, должно быть заявлено на этикетке продукта, или необходимо указать конец срока полезного использования.

5.2 Свойства микробного барьера

5.2.1 Непроницаемость материала должна определяться в соответствии с приложением С.

Примечание — Свойства микробного барьера упаковочных материалов, применяемых в конструкции барьерных систем для стерилизации, являются очень важными для обеспечения целостности и безопасности продукта. Методы оценки свойств микробного барьера подразделяются на две категории: те, которые подходят для непроницаемых материалов, и те, которые подходят для пористых материалов.

5.2.2 Демонстрация непроницаемости материала должна удовлетворять требованию к микробному барьеру.

5.2.3 Пористые материалы должны создавать достаточный микробный барьер от проникновения микроорганизмов, чтобы гарантировать целостность барьерной системы для стерилизации и безопасность продукта.

Примечание — Не существует универсального метода подтверждения свойств микробного барьера. Оценку свойств микробного барьера пористых материалов, как правило, проводят, подвергая образцы заражению спорами бактерий или микрочастиц из аэрозоля, при некоторой совокупности условий испытания, включающих скорость потока через материал, микробное заражение образца и продолжительность испытания. Свойства микробного барьера при заданных условиях определяют сравнением степени проникания бактерий или микрочастиц сквозь материал с первоначальным загрязнением. Данные валидированного метода физических испытаний, сопоставляемые с данными валидированного метода микробиологического заражения, считаются приемлемыми для определения свойств микробного барьера. Так как валидированные методы микробного заражения материалов и барьерных систем становятся доступны, они будут рассмотрены с целью включения в последующие редакции данной части ISO 11607. (За более подробной информацией обращайтесь к Sinclair и Tallentire 2002[41], Tallentire и Sinclair 1998[40], Scholla et al 1995[39], и Scholla et al. 2000[38]).

5.3 Совместимость с процессом стерилизации

5.3.1 Необходимо продемонстрировать, что материалы и отформованные барьерные системы годятся для использования в процессе(ах) стерилизации, и соответствуют параметрам цикла.

5.3.2 Совместимость стерилизации с процессом следует определять, используя стерилизатор, который спроектирован, сконструирован и работает в соответствии с требованиями определенных международных или европейских стандартов.

Примечание — Например, см. ISO 17665-1, ISO 11135, ISO 11137 (все части), ISO 14937; EN 285, EN 1422 или EN 14180. В настоящее время предпринимаются усилия по гармонизации этих международных и европейских стандартов.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

5.3.3 Необходимо оценить характеристики материалов, чтобы гарантировать их соответствие заданным пределам после того, как они были подвергнуты всем процессам стерилизации.

5.3.4 Процессы стерилизации могут включать многократное воздействие на систему одного и того же или разных процессов стерилизации.

5.3.5 При определении пригодности к предназначенному применению рассматривают материалы разного типа, которые имеются в наличии для обычных текущих поставок.

5.3.6 Если упаковка продукта представляет собой сверток или упаковка многослойна, могут быть установлены разные пределы свойств материала для внутренних и внешних слоев.

5.3.7 Определение пригодности может проводиться одновременно с валидацией процессов стерилизации.

5.4 Совместимость с системой маркировки

Система маркировки должна:

- а) оставаться неповрежденной и удобочитаемой до доставки упаковки к месту использования,
- б) быть совместима с материалами, барьерной системой и медицинским изделием во время и после процессов стерилизации и соответствовать параметрам цикла, и не должна оказывать негативного влияния на процесс стерилизации, и
- с) красители на отпечатанных или написанных этикетках не должны проникать в медицинское изделие или вступать в реакцию с упаковочным материалом и/или системой, не должны ухудшать качество упаковочного материала и/или системы, а также не должны изменять цвет до такой степени, чтобы было невозможно разобрать текст

Примечание — Системы маркировки могут иметь разные формы, включая печать или надпись непосредственно на материале и/ или барьерной системе, или этикетку, состоящую из другого слоя материала, прикрепляемого к поверхности материала и/или системы путем приклеивания, плавления или иным способом.

5.5 Хранение и транспортировка

5.5.1 Материалы и отформованные барьерные системы для стерилизации должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечить их защиту для сохранения эксплуатационных характеристик при транспортировке и хранении.

5.5.2 Материалы и отформованные барьерные системы подлежат транспортировке и хранению в таких условиях, которые гарантируют неизменность эксплуатационных характеристик в допустимых пределах (см. 5.1).

Этого можно достичь:

- a) подтверждением сохранения характеристик в определенных изготовителем условиях хранения, и
- b) поддержанием условий хранения в заданных пределах.

6 Конструктивные требования и требования к разработке упаковочных систем

6.1 Общие требования

6.1.1 Упаковочная система должна иметь такую конструкцию, которая позволит ей свести к минимуму угрозу безопасности пользователя и пациента в специально предназначенных для этого условиях пользования.

6.1.2 Упаковочная система должна обеспечивать физическую защиту и сохранять целостность барьерной системы для стерилизации.

6.1.3 Барьерная система должна давать возможность стерилизовать продукт и быть совместима с выбранными процессами стерилизации.

6.1.4 Барьерная система должна обеспечивать стерильность вплоть до места ее использования или до истечения срока годности.

Примечание — См. также 6.4.1.

6.1.5 Обеспечение целостности барьерной системы можно использовать для подтверждения сохранения стерильности.

Примечание — См. ANSI/AAMI ST65:2008 и Hansen et al. 1995[35]. Потеря стерильности финишной упаковки обусловлена воздействием событий, а не влиянием времени.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

6.1.6 Если для аналогичных медицинских изделий используется одна и та же упаковочная система, следует документально оформить

обоснование для установления сходства и идентификации конфигурации упаковки при наихудших допустимых условиях применения. Как минимум, следует использовать конфигурацию при наихудших допустимых условиях, чтобы определить соответствие настоящему стандарту.

Примечание — Например, сходство может быть установлено по разным размерам одного и того же продукта.

6.2 Конструкция

6.2.1 Следует документально оформить процедуры по конструированию и разработке упаковочных систем.

6.2.2 Барьерная система должна гарантировать предъявление продукта в асептическом виде.

6.2.3 При конструировании и разработке упаковочной системы учитывают многие факторы, но не ограничиваются только ими:

- a) требования потребителя;
- b) масса и конфигурация продукта;
- c) наличие острых кромок или выступов;
- d) потребность в физической ли иной защите;
- e) чувствительность продукта к конкретным опасностям, например, к воздействию радиации, влаги, механическому удару, статическому разряду;
- f) количество продуктов на упаковочную систему;
- g) требования к маркировке упаковки;
- h) ограничения, связанные с окружающей средой;
- i) ограничения по сроку годности продукта;
- j) среда распространения, обращения и хранения;
- k) совместимость со стерилизацией и остаточные явления.

6.2.4 Необходимо идентифицировать и определить компоненты продукта и конструкции, составляющие укупорочное средство в сборе для прохождения потока жидкости. К ним относятся, но не ограничиваются только ими:

- материалы;
- отделочное покрытие;
- размеры компонентов;
- сборочные размеры (например, допуски на посадку с натягом).

6.2.5 Результаты процесса конструирования и разработки (6.2.1, 6.2.3 и 6.2.4) должны быть зафиксированы, верифицированы и одобрены до запуска продукта в производство.

6.3 Эксплуатационные испытания упаковочной системы

6.3.1 Целостность барьерной системы должна быть продемонстрирована после стерилизации и последующих эксплуатационных испытаний.

6.3.2 Физические испытания совместно с испытанием свойств микробного барьера пористых упаковочных материалов могут применяться для определения способности барьерной системы для стерилизации сохранять стерильность.

Примечание — Более подробную информацию по данной теме можно получить в документах ANSI/AAMI ST65:2008 and Hansen et al. 1995[35].

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

6.3.3 Стандартные методы испытаний для оценки целостности барьерной системы более предпочтительны. Однако в отсутствие применимых валидированных методов испытания целостности барьерной системы рабочие характеристики микробного барьера могут быть установлены по результатам испытания свойств материалов для микробного барьера и целостности клеевых соединений и укупорочных средств.

6.3.4 Эксплуатационные испытания должны проводиться на барьерной системе, применяемой в наихудших условиях, которая изготовлена в заданных производственных пределах формирования и склеивания упаковки и после воздействия на нее всех установленных процессов стерилизации.

Примечание — К установленным процессам стерилизации можно отнести многократное воздействие одних и тех же или разных процессов стерилизации.

6.3.5 Упаковочная система должна обеспечивать адекватную защиту продукта от опасностей, возникающих при обращении с ним, транспортировке и хранении.

6.4 Испытание на стабильность характеристик

6.4.1 Испытание на стабильность характеристик должно продемонстрировать, что со временем барьерная система продолжает сохранять свою целостность.

6.4.2 Испытание на стабильность характеристик проводят, применяя процесс старения в реальном времени.

6.4.3 Испытание на стабильность характеристик с применением протоколов ускоренного старения должно рассматриваться в качестве достаточного доказательства заявленного срока годности, пока не будут получены данные исследований процесса старения в реальном времени.

6.4.4 Испытание на старение в реальном времени и ускоренное старение следует проводить одновременно.

Примечание — Испытание на старение и эксплуатационные испытания – это самостоятельные испытания. При эксплуатационных испытаниях оценивают взаимодействие между упаковочной системой и продуктами в ответ на нагрузку, перенесенную в процессе производства и стерилизации, а также в результате обращения, хранения и поставки.

6.4.5 Если срок годности установлен на основе характеристик продукта, испытание на стабильность характеристик для определения этого срока следует проводить вместе с испытанием на стабильность характеристик упаковки.

6.4.6 При проведении испытаний на ускоренное старение необходимо дать документированное обоснование условий ускоренного старения и определить продолжительность выбранного метода испытания.

6.4.7 В случае подтверждения, что с течением времени продукт не вступает во взаимодействие с конкретной барьерной системой для стерилизации, ранее документально оформленных данных для испытания на стабильность характеристик будет достаточно для установления соответствия с 6.4.1.

7 Предоставляемая информация

7.1 К материалу, отформованной барьерной системе или барьерной системе для стерилизации должна прилагаться следующая информация:

- название или торговое наименование и адрес производителя или его уполномоченного представителя;
- тип, размер или марка;
- номер партии или другие средства прослеживаемости истории производства;
- предполагаемый(е) процесс(ы) стерилизации;
- срок годности, где это применимо;
- любые особые условия хранения, где это применимо;

- любые известные ограничения по обращению или использованию (например, условия окружающей среды), где это применимо;

- для материалов многоразового использования и/или отформованных барьерных систем, частота и характер технического обслуживания;

- предназначены ли материалы и/или предварительно сформированная стерильная барьерная система для однократного или многократного использования;

- если в комплекте поставляются инструкции по применению, то в них должна быть указана дата выпуска или дата последних изменений.

(Внесено дополнительно, Изм. №1, 2014)

7.2 Если в соответствии с национальным или региональным законодательством требуется предоставление дополнительной информации с материалами, предварительно сформированной стерильной барьерной системой или стерильной барьерной системой, поставляемым на рынок медицинских услуг, то такая информация должна быть предоставлена.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

Приложение А (информативное)

Руководство по упаковке медицинских изделий

А.1 Факторы, влияющие на выбор материалов и конструкцию упаковочной системы.

Особый характер медицинского изделия, намеченные методы стерилизации, предполагаемое использование, срок годности, транспортирование и хранение – все влияет на конструкцию упаковочной системы и выбор материала. На выбор соответствующих материалов для упаковочных систем, предназначенных для финишной стерилизации медицинских изделий, влияют взаимосвязи, показанные на рисунке А.1.

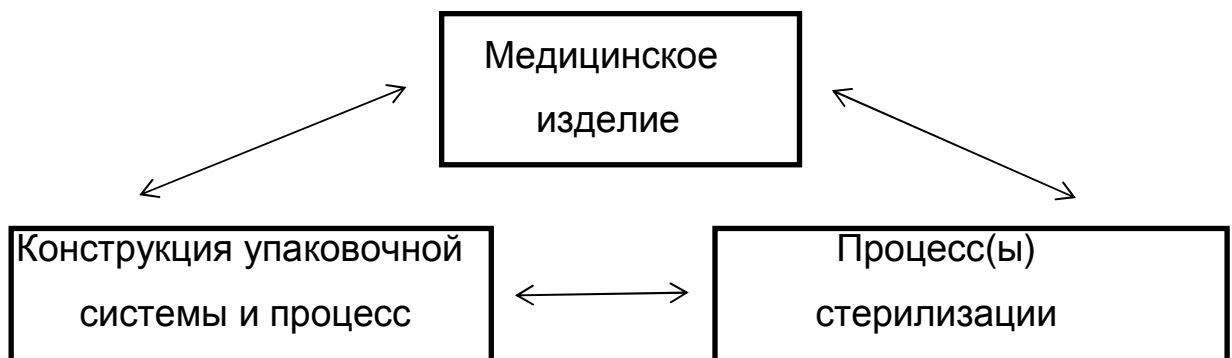


Рисунок А.1 — Взаимосвязи, влияющие на выбор соответствующих материалов для упаковочных систем, предназначенных для финишной стерилизации медицинских изделий

А.2 Процессы стерилизации и их анализ

А.2.1 Выбор процессов стерилизации включает, но не ограничивается только этим, этиленоксид (ЕО), гамма-облучение (γ), электронный луч (е-пучок), пар и низкотемпературные окислительные процессы стерилизации. Если изделие предполагается стерилизовать этиленоксидом, паром или путем окислительных процессов, то для

этого в барьерной системе имеется проницаемый компонент, который пропускает убивающие микроорганизмы стерилизующие газы, которые затем выходят без значительных остаточных концентраций.

A.2.2 Если изделие предполагается стерилизовать облучением (γ или e-пучком), проницаемый компонент может не понадобиться и барьерная система может быть изготовлена из полностью непроницаемых материалов. Изготовитель выбирает подходящие процессы стерилизации для каждого медицинского изделия, и их выбор зависит от нескольких факторов. Если изделие изготовлено из материалов, которые неустойчивы к облучению, то, как правило, применяют этиленоксид, пар и окислительные агенты. Альтернативно, если изделие имеет тенденцию накапливать высокие остаточные концентрации этиленоксида, то изготовитель изделия может выбрать процесс облучения.

A.3 Барьерные системы для стерилизации

A.3.1 Барьерные системы для стерилизации медицинских изделий могут иметь много общих характеристик. Большинство имеет верхнюю и нижнюю перегородку и средства их соединения. В том случае, когда требуется легко отслаивающееся соединение, наносят клеящий герметик, позволяющий с помощью термосклеивания соединять два слоя. Клеящий герметик, более известный как покрытие, традиционно наносится на проницаемую перегородку. В настоящее время многие пленки содержат клеящий герметик в качестве слоя(ев) пленочной конструкции. Там, где требуется сварное соединение, необходимо определить совместимость перегородок, что позволит провести термосклеивание, или использовать другие методы, такие как ультразвуковая сварка.

А.3.2 Существует много типов и видов барьерных систем для стерилизации, применяемых для упаковки стерильных медицинских изделий. Первый тип – это предварительно отформованный жесткий лоток со штампованной крышкой. Как правило, для формирования лотка применяют метод высокотемпературного формообразования или штамповку. Штампованная крышка может быть проницаемой или непроницаемой, а для термосклеивания крышки с лотком имеется клеящий герметик.

Жесткие лотки со штампованной крышкой обычно применяются для тяжелых изделий большого профиля, таких как ортопедические имплантаты и кардиостимуляторы, а также комплекты хирургических инструментов.

А.3.3 Второй тип – это гибкие расслаивающиеся саше. Саше, как правило, состоит из пленки с одной стороны и пленки, бумаги или нетканого полотна с другой. Саше обычно поставляют в виде предварительно отформованных барьерных систем для стерилизации, в которых все клеевые швы уже заделаны, за исключением одного (обычно на дне). Он остается открытым, чтобы изделие можно было положить внутрь и затем перед стерилизацией шов заделывают окончательно. Для огромного количества различных медицинских изделий саше используются в качестве барьерной системы для стерилизации, так как выпускаются разных размеров. Обычно такие медицинские изделия легкие и имеют небольшой профиль. Саше могут поставляться с разными конструктивными деталями. (Например, они могут иметь боковые и донные складки для упаковки высоких профильных изделий).

А.3.4 Третий тип – это пакеты для стерилизации. Пакет сконструирован из ординарного полотна пористой бумаги медицинского назначения, сложенного так, чтобы получился длинный

сверток с боковыми складками или без них. Сверток склеивают по всей длине двойным клеевым швом. Затем сверток отрезают до нужного размера и один конец запечатывают, наложив один шов или более. Для усиления укупорочного средства можно еще несколько раз свернуть пакет. Открытый конец обычно имеет язычок или вырез для захвата пальцами, чтобы пакет можно было легко открыть. Перед стерилизацией пакеты запечатывают окончательно.

А.3.5 К четвертому типу относится пакет, запечатываемый с помощью перегибаемой пополам этикетки. Первоначально пакет изготовлен с помощью сварного соединения двух непроницаемых, но совместимых пленочных полотен. Одно из полотен обычно смещено на несколько сантиметров. Вдоль этой смещенной области проводят термосклеивание проницаемого материала с клеем. Впоследствии этот проницаемый материал может быть снят путем отслаивания, обеспечив доступ внутрь пакета. Пакет, запечатываемый с помощью этикетки, перегибаемой пополам, широко используются для громоздких изделий, таких как медицинские инструменты.

А.3.6 Пятый тип представляет собой процесс, известный как непрерывный способ упаковывания. Барьерные системы, изготовленные таким способом, могут выглядеть как саше, жесткие лотки с крышками или могут иметь мягкое пленочное тянутое или профилированное нижнее полотно на дне. При непрерывном способе упаковывания материалы для верхней и нижней перегородки помещают в фасовочно-укупорочную машину. Машина производит барьерную систему, формируя нижнее полотно, заполняет форму медицинским изделием, прикрывает верхним полотном и запечатывает барьерную систему.

А.3.7 Шестой тип – четырехстороннее сваривание. Это непрерывный процесс упаковывания, как упаковывание "флоу-пак".

Для этого способа применяют ротационное оборудование для запечатывания. В процессе четырехстороннего сваривания нижнее и верхнее полотно помещают в машину. Изделие кладут на нижнее полотно. Накрывают верхним полотном и затем запечатывают со всех четырех сторон. Четырехстороннее сваривание применяется, например, для упаковывания перчаток и изделий для обработки ран.

А.3.8 Приведенный выше перечень барьерных систем для стерилизации является неполным. В качестве барьерных систем могут использоваться и другие конструкции.

А.3.9 Для медицинских изделий со стерильным проводником жидкости могут применяться уникальные упаковочные системы для стерильных проводников жидкости, непосредственно присоединяемых к местам доступа к устройству. Они могут включать колпачки, пробки, крышки или средства укупорки иных конструкций для специальных устройств. В этих случаях первичный слой упаковки продукта может быть представлен одним из четырех видов упаковывания, описанных выше, но при этом не требуется обеспечение микробного барьера изделий.

А.3.10 В медицинских учреждениях обычно применяются барьерные системы для стерилизации в форме саше, рулонов, бумажных пакетов, стерилизационных свертков или многоразовых контейнеров.

А.3.11 Стерилизационные свертки применяются для обеспечения барьерной системы для многих изделий, подвергаемых стерилизации в медицинских учреждениях. Применяемый вместо термосклеивания или клеящего шва способ свертывания и скручивания позволяет образовать извилистый канал, обеспечивающий стерильность. Как правило, изделия перед

завертыванием и последующей стерилизацией находятся в формованном лотке для инструментов.

А.3.12 Многоцветные контейнеры изготавливают из металла или синтетических полимерных материалов, способных выдерживать многократное воздействие циклов стерилизации в больничных условиях. Эти контейнеры обычно имеют пригнанные верхние и нижние поверхности с прокладкой, обеспечивающей непроницаемый шов между двумя частями. Система вентиляции позволяет стерилизующему агенту поступать в контейнер и выходить из него. Конструкция вентиляционной системы и материалы, обеспечивающие микробную фильтрацию, могут изменяться. Изделия, стерилизуемые в контейнерах, могут подвергаться предварительному кондиционированию или более длительному по времени воздействию стерилизующего агента, чтобы гарантировать завершение процесса стерилизации.

А.3.13 Финишная стерилизация и сохранение стерильности имеют большое значение для безопасности пациента, независимо от оборудования, с помощью которого проводятся эти процессы. Настоящий стандарт содержит минимум требований к использованию упаковочных систем, которые обеспечивают соответствующие барьерные системы для стерилизации.

Приложение В (информативное)

Стандартные методы испытаний и процедуры, которые могут применяться для демонстрации соответствия требованиям настоящего стандарта

В.1 Общие требования

Следующие документы содержат положения, которые могут применяться для демонстрации соответствия положениям данного международного стандарта. При применении методов испытаний и процессов, перечисленных в таблице В.1, необходимо обращать внимание на дату выпуска этих документов. Специальные требования по применению методов испытаний содержатся в подразделе 4.4.

Критериями для включения методов испытаний и процессов, приведённых в таблице В.1, в данное приложение, являются факты их назначения для включения и доступность для приобретения у организаций, разрабатывающих стандарты, торговых ассоциаций или национальных органов по стандартизации. Следовательно, раздел Библиография содержит дополнительные методы испытаний, которые были опубликованы в печатных изданиях. Данное приложение не является всеобъемлющим. Известно, что к моменту публикации будут разработаны новые методы испытаний.

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

В.2 Упаковочные материалы и отформованные барьерные системы для стерилизации

Таблица В.1 Методы испытаний и их статус

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
Ускоренное старение	ASTM F1980	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских изделий	НП ^a	НП	Да
	EN 868-8	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 8: Многоцветные контейнеры для стерилизации в паровых стерилизаторах, соответствующих EN 285 – Требования и методы испытаний	НП	НП	Да
Воздухопроницаемость	ISO/TS 5636-2	Бумага и картон — Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения) — Часть 2: Метод Шоппера	Нет	Нет	НП
	ISO 5636-3	Бумага и картон — Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения) — Часть 3: Метод Бендтсена	Нет	Нет	НП
	ISO 5636-5	Бумага и картон — Определение воздухопроницаемости и сопротивления воздуха (средний диапазон измерения) — Часть 5: Метод Герли	Нет	Нет	НП
	ASTM D737	Стандартный метод испытаний на проницаемость воздуха текстильных тканей	Да	-	НП
	TAPPI T460	Сопротивление воздуху у Бумаги (Метод Герли)	Да	-	НП
	TAPPI T536	Сопротивление проникновению воздуха у бумаги (Метод Герли под высоким давлением)	Да	-	НП
Стойкость к спирту	AATCC-193	Отталкивание жидкостей на основе воды: Испытание стойкости к водному/спиртовому раствору	Нет	Нет	НП

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
Основная масса	ISO 536	Бумага и картон – Определение массы	Нет	Нет	НП
	ASTM D4321	Стандартный метод испытаний выхода упаковки из пластиковой плёнки	Да	-	НП
	ASTM D3776–6M	Стандартные методы испытаний массы на единицу площади (вес) ткани	Да	-	НП
	TAPPI T410	Масса бумаги и картона (вес на единицу площади)	Да	-	НП
Биосовместимость	ISO 10993-1	Биологическая оценка медицинских изделий – Часть 1: Оценка и испытания	НП	НП	Да
	ASTM F2475	Стандартное руководство по оценке биосовместимости упаковочных материалов для медицинских изделий	НП	НП	Да
Продавливание	ISO 2758	Бумага – Определение сопротивления продавливанию	Да	-	НП
	TAPPI T403	Сопротивление продавливанию у бумаги	Да	-	НП
	ASTM F1140	Стандартные методы испытаний на сопротивление внутреннему давлению гибкой упаковки	Да	-	НП
	ASTM F2054	Стандартный метод испытаний на разрыв герметизирующих швов в гибкой упаковке при помощи нагнетания внутреннего давления в ограничительных пластинах	Да	-	НП
Хлориды	ISO 9197	Бумага, картон и целлюлоза – Определение содержания водорастворимых хлоридов	Нет	Нет	НП
	TAPPI T 256	Водорастворимые хлориды в целлюлозе и бумаге	Нет	Нет	НП
	EN 868–4	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 4: Бумажные пакеты – Требования и методы испытаний (приложение В: Метод определения значения pH, хлорида и сульфата в бумажных пакетах)	Нет	Нет ^b	НП
Чистота	TAPPI T 437	Примеси в бумаге и картоне	Да	-	НП
	TAPPI T 564	Прозрачная диаграмма для оценки размера отступов			НП
Масса покрытия	ASTM F2217	Стандартная практика определения массы покрытия/клеявого слоя	НП	НП	Да

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
Кондиционирование	ISO 187	Бумага, картон и целлюлоза – Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и методика контроля атмосферы и условий кондиционирования образцов	НП	НП	Да
	ASTM D4332	Стандартная практика кондиционирования контейнеров, упаковок или компонентов упаковки для испытания	НП	НП	Да
	ISO 2233	Упаковка – Транспортная тара с товарами и единичные грузы – Кондиционирование для испытаний	НП	НП	Да
Размеры	ASTM F2203	Стандартный метод испытания для линейного измерения с использованием линейки из прецизионной стали	Да	-	НП
Драпируемость	ISO 9073-9	Текстиль – Методы испытания нетканых материалов – Часть 9: Определение показателя драпируемости	Нет	Нет	НП
	ISO 2493-1	Бумага и картон – Определения сопротивления изгибу – Часть 1: Постоянная степень прогиба	Да	-	НП
	ISO 2493-2	Бумага и картон – Определения сопротивления изгибу – Часть 2: Шатрообразный тестер	Да	-	НП
	DIN 53121	Испытания бумаги и картона – Определение сопротивления сгибанию методом луча	Нет	Нет	НП
	TAPPI T489	Сопротивление сгибанию (жёсткость) бумаги и картона (шатрообразный тестер на жёсткость в базовой конфигурации)	Да	-	НП
	TAPPI T566	Сопротивление сгибанию (жёсткость) бумаги (шатрообразный тестер на жёсткость в конфигурации 0 до 10 единиц жёсткости)	Да	-	НП
Прочность при изгибе	ASTM F392	Стандартный метод испытания прочности при изгибе мягких барьерных материалов	Да	-	НП

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
Микробный барьер	ASTM F1608	Стандартный метод испытания для ранжирования микробов в пористых упаковочных материалах (Камера облучения)	Да	-	НП
	ASTM F2638	Стандартный метод испытания применения аэрозольной фильтрации для измерения рабочих характеристик пористых упаковочных материалов в качестве замещения микробного барьера	Да	-	НП
	DIN 58953-6	Стерилизация – Обеспечение стерильной поставки – Часть 6.: Испытание микробиологического барьера упаковочных материалов для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Бумага для упаковочных пакетов и свертков – испытание, подпункт 2.14: Испытание микроорганизмов на устойчивость к влаге и раздел 15: Испытание микроорганизмов на устойчивость при прохождении воздуха	Да ^{f, g}	НП ^f	НП
	BS 6256	Технические условия на бумагу для стерилизационных бумажных мешков, пакетов и рулонов медицинского назначения, приложение С: Методы определения проникновения твердых частиц с помощью метиленового синего	Нет	Нет	НП
	ASTM F2101	Метод испытания для оценки эффективности фильтрации микробов через медицинские маски для лица с помощью биологического аэрозоля с золотистым стафилококком	-	Да	НП
	SS 876 0019	Медицинский текстиль – Проникновение микробов – Влажная среда	Нет	Нет	НП
	Проницаемость кислорода	ASTM D3985	Стандартный метод испытаний на скорость проникания кислородного газа через пластиковую плёнку и листы с применением кулонометрического датчика	Да	-
	ASTM F1307	Стандартный метод испытаний на скорость проникания кислорода внутрь сухих упаковок с применением кулонометрического датчика	Да	-	НП

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
	ASTM F1927	Стандартный метод испытаний на определение скорости проникания кислородного газа и проницаемости при контролируемой относительной влажности через барьерный материал с применением кулонометрического датчика	Да	-	НП
	ASTM F2622	Стандартный метод испытаний на скорость проникания кислородного газа через пластиковую плёнку и листы с применением различных датчиков	Да	-	НП
Способность к открытию отслаиванием	EN 868-5	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации - Часть 5: Запечатываемые пакеты и рулоны, изготовленные из пористых материалов и пластиковой плёнки – Требования и методы испытаний (приложение С: Определение способности к отслаиванию изделий из многослойной бумаги и слоистого пластика)	Нет	Нет	НП
Испытание рабочих характеристик	ASTM D4169	Испытание рабочих характеристик при поставке контейнеров и упаковочных систем	НП	НП	Да
	ISTA 1,2 and 3 Series	Предпоставочные методы испытаний, разработанные Международной ассоциацией по безопасности транзитных перевозок	НП	НП	Да
	ISTA 4AB	Упаковано – изделия для доставки по известным каналам сбыта	НП	НП	Да
	ISTA 7D	Упаковка с контролируруемыми температурными показателями для систем доставки посылок	НП	НП	Да
	ISO 4180	Упаковка - Укомплектованная упаковка для транспортирования – Руководство к составлению режимов эксплуатационных испытаний.	НП	НП	Да
	EN 868-8	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 8: Многократные контейнеры для стерилизации в паровых стерилизаторах, соответствующих EN 285 – Требования и методы испытаний	Нет	Нет	НП
	ASTM F2825	Стандартная практика подчёркивания климатических условий в упаковочных системах при доставке одной посылки	НП	НП	Да

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
	ASTM D7386	Стандартная практика испытания рабочих характеристик упаковки при доставке одной посылки	НП	НП	Да
рН	ISO 6588-1	Бумага, картон и целлюлоза – Определение рН водных экстрактов – Часть 1: Холодная экстракция	Да	-	НП
	ISO 6588-2	Бумага, картон и целлюлоза – Определение рН водных экстрактов – Часть 1: Горячая экстракция	Да	-	НП
	TAPPI T509	Концентрация водородных ионов (рН) экстрактов бумаги (метод холодной экстракции)	Да	-	НП
	TAPPI T435	Концентрация водородных ионов (рН) экстрактов бумаги (метод горячей экстракции)	Да	-	НП
Размер пор	EN 868–2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 2: Упаковка для стерилизации – Требования и методы испытаний (приложение С: Метод определения размера пор ^с)	Нет	Нет ^b	НП
Печать и покрытие	ASTM F2250	Стандартный метод оценки стойкости к химическому воздействию красок для печати и покрытий для мягких упаковочных материалов	НП	НП	Да
	ASTM F2252	Стандартный метод оценки сцепления краски и покрытия с мягкими упаковочными материалами с использованием липкой ленты	НП	НП	Да
Прокол	ASTM D1709	Стандартный метод испытания для определения стойкости к ударным нагрузкам пленки из пластмассы с применением свободнопадающего дротика	Да	-	НП
	ASTM F1306	Стандартный метод испытания для определения проколостойкости при малой скорости гибких барьерных плёнок и ламинатов	Да	-	НП
	ASTM D3420	Стандартный метод испытания для определения стойкости к ударным нагрузкам плёнки из пластмассы с применением маятника	Да ^d	-	НП
Прочность соединения	ASTM F88/F88M	Стандартный метод испытания для определения прочности соединения гибких барьерных материалов	Да	-	НП

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
	EN 868-5	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 5: Запечатываемые пакеты и рулоны, изготовленные из пористых материалов и пластиковой плёнки – Требования и методы испытаний	Нет	Нет	НП
Разработка технических условий	ASTM F2559 /2559F	Стандартное руководство по написанию технических условий для стерилизационной упаковки, открывающейся с помощью расслаивания	НП	НП	Да
	ASTM F99	Стандартное руководство по написанию технических условий для гибких рулонных барьерных материалов	НП	НП	Да
	ASTM F17	Стандартная терминология, относящаяся к гибкой барьерной упаковке	НП	НП	Да
	ASTM F2097	Стандартное руководство по моделированию и оценке первичной гибкой упаковки для медицинских изделий	НП	НП	Да
Статическое электричество	BS 6524	Метод определения поверхностного удельного сопротивления текстильных тканей	Нет	Нет	НП
	ASTM D257	Стандартные методы испытаний на сопротивление постоянному току или проводимости диэлектрических материалов	-	Да	НП
Целостность стерильной барьерной системы	ASTM F2228	Стандартный метод испытания на не деструктивное обнаружение утечек в медицинской упаковке, который соединяет пористый барьерный материал методом применения контрольного газа CO ₂	Да		НП
	ASTM F1929	Стандартный метод испытания на обнаружение утечек в герметизирующем шве в пористой медицинской упаковке с помощью проникновения красителя	Да	-	НП
	ASTM F2227	Стандартный метод испытания на не деструктивное обнаружение утечек в не закрытых герметично и в пустых лотках для медицинской упаковки методом применения контрольного газа CO ₂	Да	-	НП
	ASTM F2391	Стандартный метод испытаний на выявление целостности упаковки и герметизирующего шва с использованием гелия в качестве контрольного газа	Да	-	НП

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
	ASTM F2096	Стандартный метод испытаний на обнаружение общих утечек в упаковке путём нагнетания внутреннего давления (Тест на появление пузырьков)	Да	-	НП
	ASTM F1886/ F1886M	Стандартный метод испытаний на определение целостности герметизирующих швов в медицинской упаковке путём визуального контроля	Да	-	НП
	ASTM F2338	Стандартный метод испытания на не деструктивное обнаружение утечек в упаковках путём вакуумного распада	Да	-	НП
	ASTM D3078	Стандартный метод испытания на не деструктивное обнаружение утечек в гибкой упаковке путём образования пузырьков	Да	-	НП
	ASTM F2095	Стандартные методы испытаний на утечку при снижении давления в гибкой упаковке с применением и без применения ограничительных пластин	Да	-	НП
Сульфаты	ISO 9198	Бумага, картон и целлюлоза – Определение водорастворимых сульфатов	-	Да	НП
	TAPPI T255	Водорастворимые сульфаты в целлюлозе и бумаге, метод испытаний	-	Да	НП
	EN 868–4	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 4: Бумажные пакеты – Требования и методы испытаний (приложение В: Метод определения значения pH, хлорида и сульфата в бумажных пакетах)	Нет	Нет	НП
Сопротивление разрыву	ASTM D1922	Стандартные испытания для определения сопротивления распространению разрыва пленки из пластмассы и пластмассовых лент методом маятника	Да	-	НП
	ASTM D1938	Стандартный метод испытания для определения сопротивления распространению разрыву пленки из пластмассы (раздвоенный разрыв) и пластмассовых лент методом одиночного разрыва	Да	-	НП
	ISO 1974	Бумага – Определение сопротивления раздиру (метод Эльмендорфа)	Нет	Нет	НП
Свойства при растяжении	ISO 1924-2	Бумага и картон – Определение свойств при растяжении – Часть 2: Метод удлинения с постоянной скоростью	Да	-	НП

Продолжение таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
	ISO 1924-3	Бумага и картон – Определение свойств при растяжении – Часть 3: Метод удлинения с постоянной скоростью (100мм/мин)	Да	-	НП
	ASTM D882	Стандартный метод испытания для определения свойств при растяжении тонких пластмассовых лент	Да	-	НП
	TAPPI T494	Свойства при растяжении бумаги и картона (с применением прибора удлинения с постоянной скоростью)	Да	-	НП
Толщина/плотность	ISO 534	Бумага и картон – Определение толщины, плотности и удельного объема	Да	-	НП
	ASTM F2251	Стандартный метод испытания для измерения толщины гибких упаковочных материалов	Да	-	НП
	TAPPI T551	Толщина бумаги и картона (метод мягкого валика)	Да	-	НП
	TAPPI T411	Толщина (мерная) бумаги и картона.	Да	-	НП
Утечка вакуума	EN 868–8	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 8: Многократные контейнеры для стерилизации в паровых стерилизаторах, соответствующих EN 285 – Требования и методы испытаний	Нет	Нет	НП
Визуальный контроль	EN 868–8	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 8: Многократные контейнеры для стерилизации в паровых стерилизаторах, соответствующих EN 285 – Требования и методы испытаний	Нет	Нет	НП
Водостойкость	ISO 811	Ткани – Определение водостойкости – Испытание гидростатическим давлением	Нет	Нет	НП
	EDANA 170–1	Влажный барьер – Банка с завинчивающейся крышкой	Нет	Нет	НП
	EN 20535	Бумага и картон – Определение влагопоглощения методом Кобба	Нет	Нет	НП
	AATCC-127	Водостойкость: испытание гидростатическим давлением	Нет	Нет	НП
	TAPPI T441	Влагопоглощение определённого размера (непитывающих) бумаги, картона и гофрированного картона (метод Кобба)	Да	-	НП

Окончание таблицы В.1

Свойство/особенности	Ссылка на документ	Наименование документа	Метод испытаний имеет подтверждение точности и/или погрешности, стабильности, воспроизводимости	Метод испытаний имеет только подтверждение точности и/или погрешности	Руководство, стандартные методы
	EN 868–2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации – Часть 2: Упаковка для стерилизации – Требования и методы испытаний (приложение С: Метод определения водонепроницаемости пор ^е)	Нет	Нет	НП
Продавливание во влажном состоянии	ISO 3689	Бумага и картон – Определение сопротивления продавливанию после погружения в воду	Нет	Нет	НП
Свойства при растяжении во влажном состоянии	ISO 3781	Бумага и картон – Определение прочности при растяжении после погружения в воду	Нет	Нет	НП
	TAPPI T456	Разрушающее усилие при растяжении насыщенной водой бумаги и картона («разрывное усилие во влажном состоянии»)	Да	-	НП
<p>а НП – Не применяется</p> <p>б Для подтверждения точности и/или погрешности, см. Berry, C. W. и Harding, L. (2012), Валидация методов испытаний для описания и определения материалов, применяемых в изготовлении стерилизационной упаковки. Packag. Technol. Sci.</p> <p>с Метод испытаний для определения размера пор также приведён в, EN 868–3:2009 приложение D, EN 868–6:2009 и EN 868–7:2009.</p> <p>д стандарт ASTM имеет только подтверждение точности.</p> <p>е Метод испытаний на водостойкость также приведён в, EN 868–3:2009 приложение D, EN 868–6:2009 и EN 868–7:2009.</p> <p>ф Испытание может быть пройдено либо не пройдено. Погрешность является устаревшей.</p> <p>г Подтверждение стабильности и воспроизводимости см. в D. Zahn, ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH. Межлабораторное испытание – «Испытание микробного барьера в упаковочных материалах для медицинских изделий, подлежащих стерилизации» в соответствии с DIN 58953-6:2010</p>					

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

Приложение С (нормативное)

Метод испытания для определения сопротивления непроницаемых материалов прохождению воздуха

С.1 Непроницаемые материалы для барьерных систем для стерилизации подлежат испытанию на воздухопроницаемость в соответствии с ISO 5636-5.

Критерий испытания: Спустя минимум 1 ч не должно быть видимого движения цилиндра, допуск $f \pm 1$ мм.

С.2 Для стандартного мониторинга и производственных испытаний могут применяться другие методы. Однако эти методы должны быть валидированы в соответствии со стандартным методом испытания (см. примечание С.1) для применяемых материалов.

Примечание – Примеры таких методов приводятся в приложении В. Для определения воздухопроницаемости могут применяться такие методы, как, например, метод Шоппера в соответствии с ISO 5636-2. Коэффициенты пересчета для разных типов аппаратуры, применяемой для различных методов определения воздухопроницаемости, даны в ISO 5636-1.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответ- ствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
ISO 5636-5	—	*
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов Российской Федерации.		

Библиография

- [1] ISO 186:2002 Бумага и картон. Отбор образцов для определения среднего качества (Paper and board. Sampling to determine average quality)
- [2] ISO 2859-1:1999 Процедуры выборочного контроля по качественным признакам. Часть 1. Планы выборочного контроля с указанием приемлемого уровня качества (AQL) для последовательного контроля партий (Sampling procedures for inspection by attributes. Part 1. Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection)
- [3] ISO 5636-1:1984 Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 1. Общий метод (Paper and board. Determination of air permeance (medium range). Part 1. General method)
- [4] ISO 5636-2:1984 Бумага и картон. Определение воздухопроницаемости (средний диапазон измерения). Часть 2. Метод Шоппера (Paper and board. Determination of air permeance (medium range). Part 2. Schopper method)
- [5] ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (Quality management systems. Fundamentals and vocabulary)

- [6] ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования
(Quality management systems. Requirements)
- [7] ISO 10993-1:2009 Биологическая оценка медицинских изделий.
Часть 1. Оценка и испытания в рамках
процесса менеджмента риска (Biological
evaluation of medical devices. Evaluation and
testing within a risk management process)
- [8] ISO 11135:2014 Стерилизация медицинских изделий. Оксид
этилена. Требования к разработке, валидации
и текущему контролю процесса стерилизации
медицинских изделий (Sterilization of health-
care products. Ethylene oxide. Requirements for
the development, validation and routine control of
a sterilization process for medical devices)
- [5] - [8] (Измененная редакция, Изм. №1, 2014)**
- [9] ISO 11137-1:2006 Стерилизация медицинской продукции.
Облучение. Часть 1. Требования к разработке,
валидации и текущему контролю процесса
стерилизации медицинских изделий
(Sterilization of health care products. Radiation.
Part 1. Requirements for development, validation
and routine control of a sterilization process for
medical devices)
- [10] ISO 11137-2:2006 Стерилизация медицинской продукции.
Часть 2. Установление стерилизующей дозы
(Sterilization of health care products. Radiation.
Part 2. Establishing the sterilization dose)

- [11] ISO 11137-3:2006 Стерилизация медицинской продукции. Облучение. Часть 3. Руководство по вопросам дозиметрии (Sterilization of health care products. Radiation. Part 3. Guidance on dosimetric aspects)
- [12] ISO/TS 11139:2006 Стерилизация санитарно-гигиенических изделий. Словарь (Sterilization of health care products. Vocabulary)
- [13] ISO 11607-2:2006 Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки (Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 2. Validation requirements for forming, sealing and assembly processes)
- [14] ISO 13485:2003 Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования к регулированию (Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes)
- [16] ISO 14937:2000 Стерилизация медицинской продукции. Общие требования для определения характеристик стерилизующего вещества и для разработки, валидации и текущего контроля процессов стерилизации медицинских изделий (Sterilization of health

care products. General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices)

- [17] ISO 17665-1:2006 Стерилизация медицинских изделий. Водяной пар. Часть 1: Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий (Sterilization of health care products. Moist heat. Part 1. Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices)
- [18] EN 285+A2:2009 Стерилизация. Стерилизаторы паровые крупногабаритные (Sterilization. Steam sterilizers. Large sterilizers)

[17] - [18] (Измененная редакция, №1, 2014)

[19] - [22] (Исключено, Изм. №1, 2014)

- [23] EN 868-2:1999 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 2. Свертки для стерилизации. Требования и методы испытаний (Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized . Part 2. Sterilization wrap. Requirements and test methods)
- [24] EN 868-3:2009 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для

стерилизации. Часть 3. Бумага для изготовления бумажных пакетов (технические условия в EN 868-4) и изготовления прозрачных пакетов и трубок (технические условия в EN 868-5). Требования и методы испытаний Requirements and test methods (Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 3. Paper for use in the manufacture of paper bags (specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5.)

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

[25] EN 868-4:1999 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 4. Бумажные пакеты. Требования и методы испытаний (Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized. Part 4. Paper bags. Requirements and test methods)

[26] EN 868-5:2009 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 5. Термостойкие самозапечатающиеся пакеты и рукава из пористых материалов и многослойной пластиковой пленки. Требования и методы испытаний (Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 5. sealable pouches and reels of porous materials and plastic film

construction. Requirements and test methods)

(Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

- [27] EN 868-6:2009 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 6. Бумага для низкотемпературной стерилизации. Требования и методы испытаний (Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 6. Paper for low temperature sterilization processes. Requirements and test methods)
- [28] EN 868-7:2009 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 7. Проклеенная бумага для стерилизации при низкой температуре. Требования и методы испытаний (Packaging for terminally sterilized medical devices. Part 7. Adhesive coated paper for low temperature sterilization processes. Requirements and test methods)

[26] - [28] (Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

- [29] EN 868-8:1999 Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 8. Стерилизационные контейнеры многократного применения для паровых стерилизаторов в соответствии с EN 285. Требования и методы испытаний

(Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized. Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285. Requirements and test methods)

[30] EN 868-9:2000

Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 9. Нетканые материалы из полиолефинов без покрытия для изготовления термосвариваемых прозрачных пакетов, рулонов и крышек. Требования и методы испытаний (Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized. Part 9. Uncoated nonwoven materials of polyolefines for use in the manufacture of heat sealable pouches, reels and lids. Requirements and tests methods)

[31] EN 868-10:2000

Материалы и системы для упаковки медицинских приборов, предназначенных для стерилизации. Часть 10. Нетканые материалы из полиолефинов с клеевым покрытием для изготовления термосвариваемых саше, рулонов и крышек. Требования и методы испытаний (Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized. Part 10. Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines for use in the manufacture of heat

sealable pouches, reels and lids. Requirements and test methods)

- [32] EN 1422:1997 Стерилизаторы медицинского назначения. Стерилизаторы на основе оксида этилена. Требования и методы (Sterilizers for medical purposes. Ethylene oxide sterilizers. Requirements and test methods)
- [33] EN 13795-1+A1:2009 Хирургические покрывала, накидки, плащи с широкими рукавами, используемые в качестве медицинских изделий, для пациентов, медицинского персонала и оборудования. Часть 1. Общие требования для заводов-изготовителей, производителей и готовых изделий (Surgical drapes, gowns and clean air suits used as medical devices, for patients, clinical staff and equipment. Part 1. General requirements for manufacturers, processors and products)
- [34] EN 14180+A2:2009 Стерилизаторы медицинского назначения. Низкотемпературные паровые и формальдегидные стерилизаторы. Требования и испытания (Sterilizers for medical purposes. Low temperature steam and formaldehyde sterilizers. Requirements and testing)
- [35] AAMI/ANSI ST 65:2008 Обработка многоразовых хирургических текстильных изделий, применяемых в

медицинских учреждениях (Processing of reusable surgical textiles for use in health care facilities)

[33] - [35] (Измененная редакция, Изм. №1, 2014)

- [36] Hansen, J., Jones, L., Anderson, H., Larsen, C., Scholla, M., Spitzley, J., and Baldwin, A. 1995. In quest of sterile packaging: Part 1; Approaches to package testing. Med. Dev. & Diag. Ind. 17 (8):pp. 56-61
- [37] Jones, L., Hansen, J., Anderson, H., Larsen, C., Scholla, M., Spitzley, J., and Baldwin, A. 1995. In quest of sterile packaging: Part 2; Approaches to package testing. Med. Dev. & Diag. Ind. 17 (9):pp. 72-79
- [38] Scholla, M., Hackett, S., Rudys, S., Michels, C. and Bletsos, J. 2000. A potential method for the specification of microbial barrier properties. Med. Dev. Technol. 11 (3): pp. 12-16
- [39] Scholla, M., Sinclair, C.S., and Tallentire, A. (1995). A European Consortium Effort to Develop a Physical Test for Assessing the Microbial Barrier Properties of Porous Medical Packaging Materials. In: Pharm. Med. Packaging 95, Copenhagen, Denmark
- [40] Tallentire, A. and Sinclair, C.S. (1996). A Discriminating Method for Measuring the Microbial Barrier Performance of Medical Packaging Papers. Med. Dev. Diag. Ind., 18 (5), pp. 228-241
- [41] Sinclair, C.S. and Tallentire, A. (2002) Definition of a correlation between microbiological and physical articulate barrier

performances for porous medical packaging materials. PDA J. Pharm. Sci. Technol. 56 (1): pp. 11-9

- [42] Junghannß, U., Winterfeld, S., Gabele, L. and Kulow; U. Hygienic-Microbiological and Technical Testing of Sterilizer Container Systems, Zentr. Steril. 1999; 7 (3) pp. 154-162 under Sterile barrier systems, Package Integrity
- [43] Gabele, L. and Junghannß, U. Untersuchung zur Lagerdauer von Sterilgut unter Einbezug des Sterilcontainers; Aseptica 6, 2000, pp. 5-7
- [44] Merkblatt 45, Verpackungs-Rundschau 5/1982; Prüfung von Heißsiegelnähten auf Dichtigkeit, Herausgegeben von den Arbeitsgruppen der Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e. V. am Fraunhofer-Institut für Lebensmitteltechnologie und Verpackung, Institut an der Technischen Universität München
- [45] Dunkelberg, H. and Wedekind, S. A New Method for Testing the Effectiveness of the Microbial Barrier Properties of Packaging Materials for Sterile Products; Biomed. Technik, 47 (2002), pp. 290-293
- [46] Test method for the microbial barrier properties of wrapping materials, new approach; Report No. 319 011.007 RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene), Netherlands
- [47] Test method for the microbial barrier properties of packaging for medical devices; Report No. 31900, RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene), Netherlands
- [48] International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology: 1993, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML

[49] AORN Journal 26 (21:334-350) Microbiology of Sterilization. Litsky, Bertha, Y. 1977

[50] USP 27<1031> The biocompatibility of materials used in drug containers, medical devices and implants

[51] Berry, C. W. and Harding, L. (2012), Валидация методов испытаний для описания и определения материалов, применяемых в изготовлении стерилизационной упаковки. Packag. Technol. Sci.

[52] D. Zahn, ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH. Межлабораторное испытание – «Испытание микробного барьера в упаковочных материалах для медицинских изделий, подлежащих стерилизации» в соответствии с DIN 58953-6:2010. Доступно онлайн через Ассоциацию Стерильного Барьера (SBA) <http://www.sterilebarrier.org/media/43501/Final-validation-report-germproofness-plus-author.pdf>

[51], [52] (Введены дополнительно, Изм.№1)

УДК 615.478.73:006.354

МКС 11.080.30

P26

IDT

Ключевые слова: упаковка, медицинские изделия, финишная
стерилизация, материалы, барьерные системы, упаковочные системы

Руководитель организации разработчика:

ООО «Дюпон Наука и Технологии»

Генеральный директор

Чуканкина О.В.

Руководитель разработки

ООО «Дюпон Наука и Технологии»

Пензов К.С.

Исполнитель

Рубан Г.И.

ГОСТ
(проект, RU, первая редакция)

УДК 615.478.73:006.354 МКС 11.080.30 Р26 IDT

Ключевые слова: упаковка, медицинские изделия, финишная
стерилизация, материалы, барьерные системы, упаковочные системы

Руководитель организации разработчика:

ООО «Дюпон Наука и Технологии»

Генеральный директор



Чуканова О.В.

Руководитель разработки

ООО «Дюпон Наука и Технологии»

A blue ink signature, likely belonging to K.S. Penzov, written over the company name.

Пензов К.С.

Исполнитель

A blue ink signature, likely belonging to G.I. Ruban, written next to the word 'Исполнитель'.

Рубан Г.И.